



iTera-Bio

iTera-Bio 生物能量仪

70%的人正经历的 亚健康状态



疲劳乏力、紧张焦虑、
头疼头晕




精神无法集中、
记忆力减退



痛风、身体沉重



腹胀腹痛、消化不良、
便秘

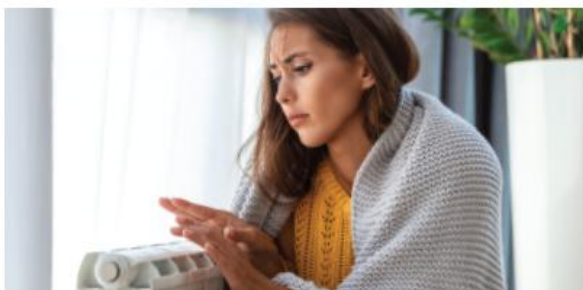

体温偏低、手足冰冷



女性月经不调

人虚则寒，寒则湿，湿则凝，凝则瘀，瘀则堵，堵则瘤，瘤则癌。
万病之源就是寒湿！

请注意！大病都是由小病一步步积累而成的！

- 虚→累、疲劳、犯困、没有精神
- 寒→怕冷、怕吹空调、晚上睡觉感觉冷
- 湿→身体“湿”气重的人，像穿了一件淋过雨的衣服，感觉身体重与不舒服
- 凝→身体容易酸、痛
- 瘀→身体酸痛、麻木。胀痛、浑身不舒服
- 堵→堵时间长了就容易生病
- 瘤→长“瘤”不可怕，怕的是恶性肿瘤，恶性肿瘤容易变异形成癌病
- 癌→癌是个很恐怖的事情，可能为时已晚了



生物能量仪

激活身体细胞能量

iTera-Bio

排寒除湿

活化细胞

促进代谢

净化身体

促进循环

透热燃脂

塑形抗衰

缓解炎症





iTera-Bio

具有三大核心技术

第一重

太赫兹波通过光谱成像对人体细胞进行精准探测细胞异常情况，起到爆破坏细胞，活化沉睡细胞功能。

第二重

负离子 - 被称为空气维生素，除了净化空气，也是血液的清道夫，能柔化血管，预防动脉硬化，并具备提高免疫力，抗氧化，减缓焦虑，安神助眠的功效，减缓过敏和哮喘。



*负离子浓度达到 $10,000/\text{cm}^3$ 个以上能增强人体自然痊愈能力。iTera-Bio 释放 $10,000,000/\text{cm}^3$ 的负离子。

第三重

石墨烯远红外线迅速提升皮肤表面温度，促使血液循环加速，缓和肌肉紧张，减轻疼痛。

三重能量，功效叠加

两个或多个振动频率相同的物体， 当一个发生振动时， 另一个物体， 或许多物体也随之振动， 就叫同频共振。宇宙就是物与物相互共振的结晶。

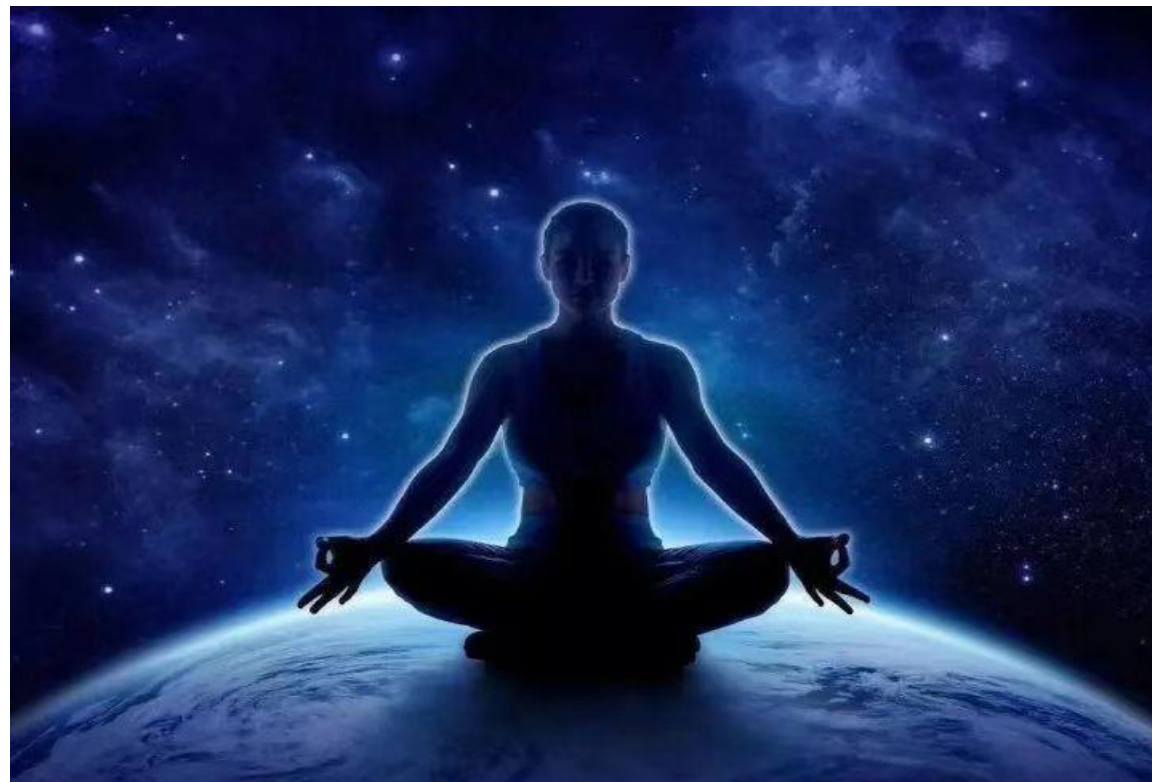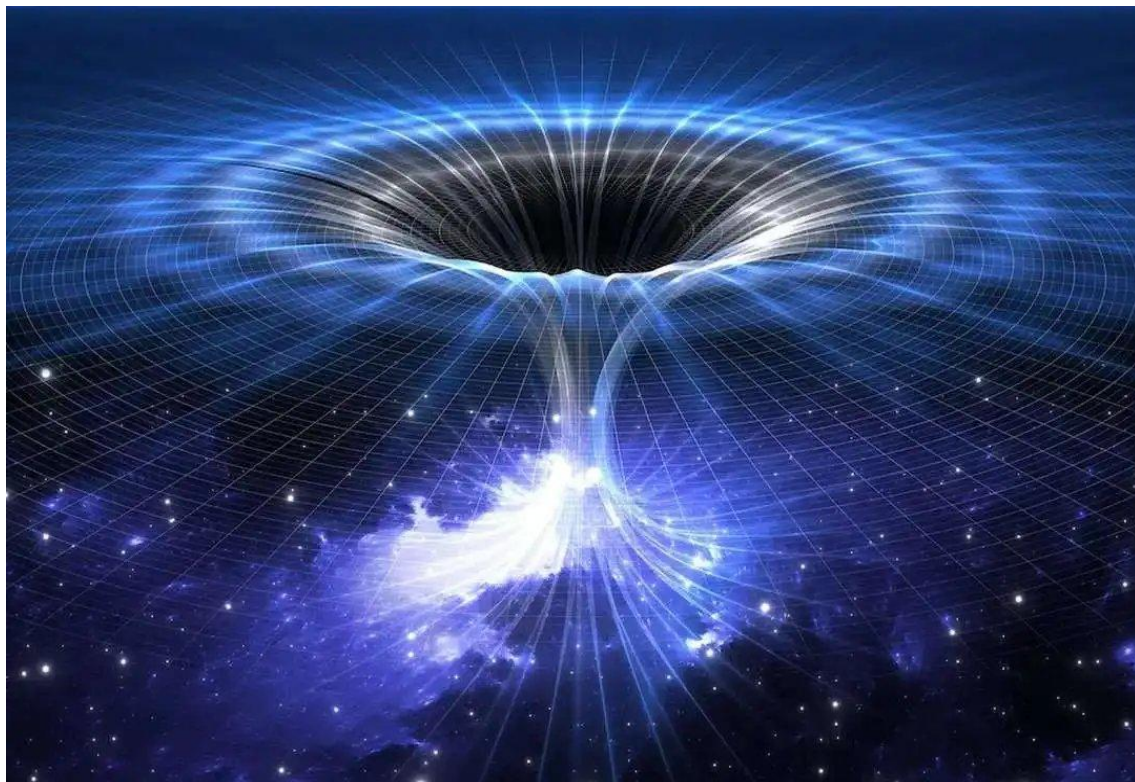



主要功效

iTera-Bio



杀

杀菌康养



热

红外热疗




祛

祛寒排湿，缓解炎症




塑

减脂塑型

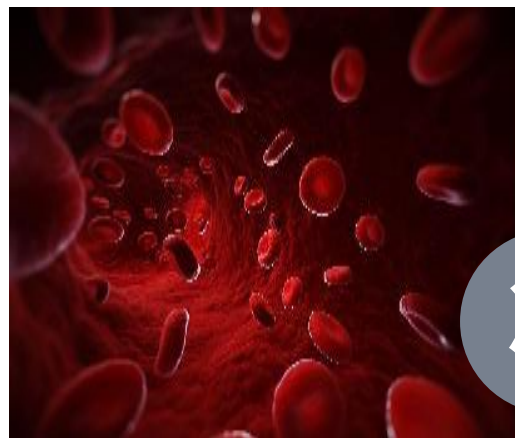

净

净化身体

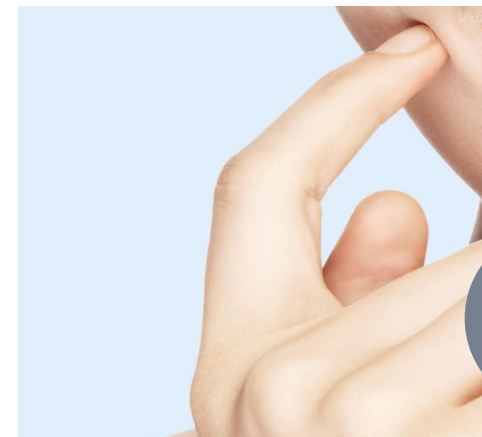

美

美容抗衰

 Prife

杀菌康养

iTera-Bio

杀



千万级负氧离子

除味杀菌：

异味、真菌感染、脚气、
汗脚.....

**从脚到全身做个
深度“SPA”！**



热

石墨烯远红外可**穿透皮下3-4厘米**，容易被组织吸收

1. **迅速提升**表面温度，皮下血液循环**加速**
2. 缓和肌肉紧张，**减轻**疼痛，**调节**自主神经
3. **增加**新陈代谢、酵素活性、**促进**血管扩张
4. 提高微血管**通透**性，帮助排出废物，**加速**伤口愈合
5. **增加**肌肉伸缩能力，**解除**疼痛和肌肉痉挛
6. **减少**血液粘稠度，**减轻**僵硬不适



寒冷的天气也无须担心冰冷！

祛寒除湿 缓解炎症

祛

(1) 增加白血球数量，增强灭菌能力达到消炎作用，同时注入神经时会麻醉神经，舒缓因神经过度紧张引起的各类疼痛。


(2) 使血管扩张，血流阻力及血液粘度降低，改善微循环，增加储氧及排除二氧化碳能力，人体营养运到全身，器官正常工作，免疫机能充分发挥作用，就会少得病甚至不得病。



减脂塑形

塑

- (1) 对运动神经产生作用，肌肉产生有节律的收缩放松，改善肌肉局部组织血液循环和营养代谢 过程的加速。
- (2) 提高肌力，防止肌肉萎缩，促进神经的再生机能，同时向中枢神经传递冲动，精神焕发，精力充沛，不乏力。
- (3) 分解体内多余的脂肪细胞，排除毒素，有助人体抗和消除自由基损害，更年轻。
- (4) 使有病部位细胞内的分子重新排列，变无序为有序，变无规律为有规律，补益脾胃、调和气血、使肌体 产生良性循环，多余脂肪被分解，恢复正常代谢功能。

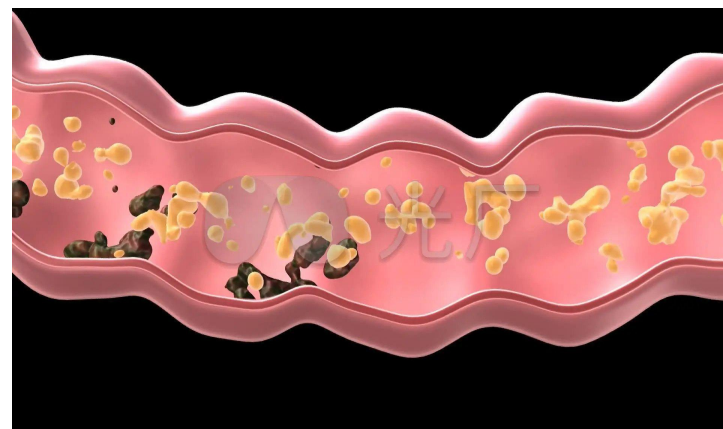




(1) 血液循环加快，快速代谢并排除体内酸性物质，血液碱性化，使粘附在血管壁的胆固醇、甘油三脂等物质分解代谢，改善体内环境




通瘀堵

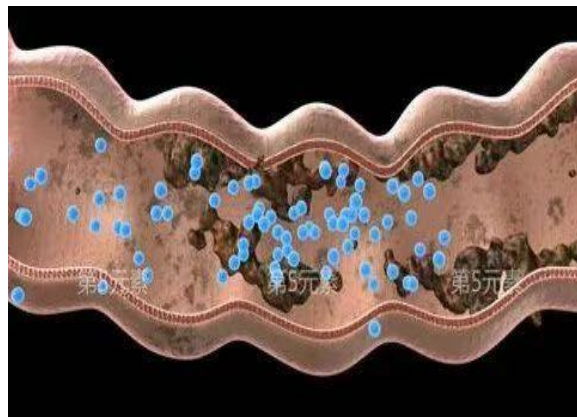

排肠毒



燃脂肪

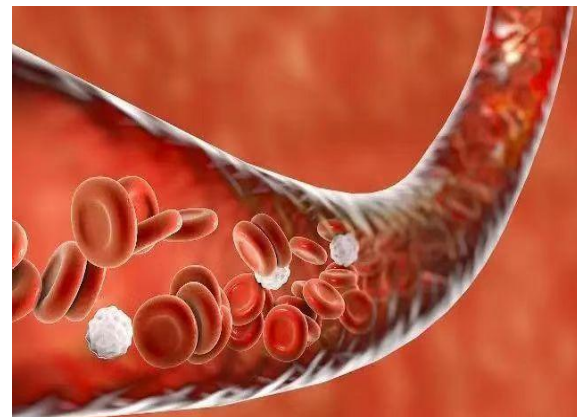

清毒素



- (1) 祛斑/除皱/消除黑眼圈/眼袋
- (2) 肌肤富有光泽和弹性
- (3) 靓白, 润泽, 红润
- (4) 排毒/加速新陈代谢/活血化淤、活化细胞、
内外调节



iTera-Bio各种生物能量激活
细胞活力, 刺激胶原蛋白再生,
延缓肌肤衰老并抚平皱纹!




高端大气 核心科技


iTera-Bio



自启动检测
中途离开，断点记忆

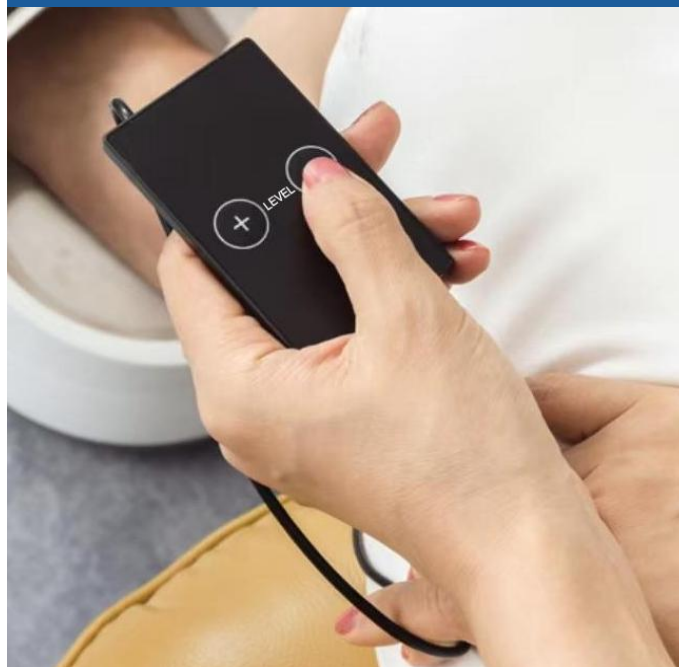

IMD显示系统
(IN-Mold-Decoration)

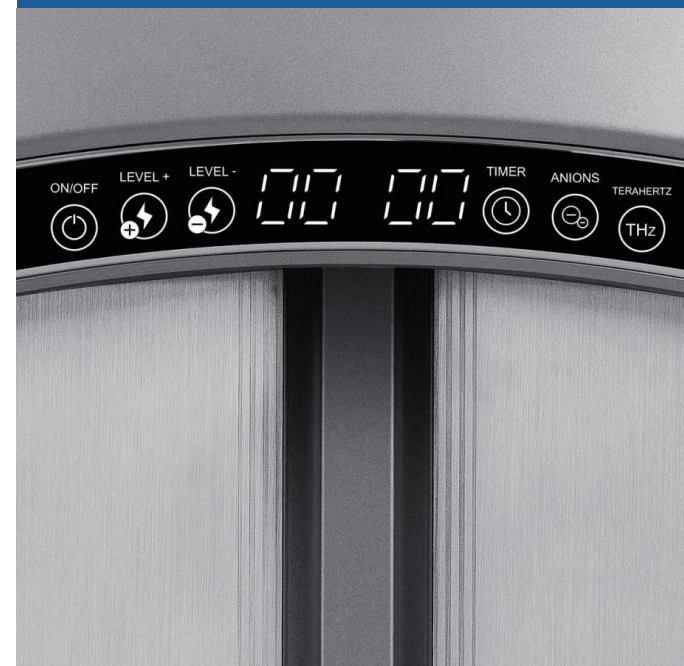

检验报告



检验报告


TEST REPORT

(本报告未经允许不得部分复制)

报告编号: LCS211214021AS
样品名称: 生物能量仪
型号规格: MLS-JC-01A
检验类别: 委托检验
委托单位: 木林森(广东)健康科技有限公司



深圳立讯检测股份有限公司 | 地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基工业园 A 栋 101、201、C 栋 301
Room 101, 201, Building A and Room 301, Building C, Juji Industrial Park, Yabianxueziwei, Shajing
Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | Tel: +(86) 0755-8259 1330 |
Fax: +(86) 0755-8259 1332 | E-mail: webmaster@lcs-cert.com | http://www.lcs-cert.com
扫码查询真伪 Scan code to check authenticity



第 1 页 共 54 页

报告编号: LCS211214021AS

检验报告

样品名称	生物能量仪	商标	MLS
型号规格	MLS-JC-01A	电气参数	输入: 220V~, 50Hz, 270W 输出: 5V _{DC} , 1A
生产单位	木林森(广东)健康科技有限公司		
制造单位	木林森(广东)健康科技有限公司		
委托单位	木林森(广东)健康科技有限公司		
生产方地址	广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号办公大楼		
制造方地址	广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号办公大楼		
委托方地址	广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号办公大楼		
检验单位	深圳立讯检测股份有限公司		
检验方地址	广东省深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基工业园 A 栋 101、201、C 栋 301		
送样日期	2021 年 12 月 14 日	送样数量	2 台
检验日期	2021 年 12 月 14 日 - 2021 年 12 月 31 日	检验环境	15-25°C, 45-75%RH
取样方式	客户送样	样品状态	试验前样品完好
检验项目	见报告正文和条款		
检验依据	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》		
检验结论	根据标准要求对样品进行试验, 所检项目符合标准要求。	深圳立讯检测股份有限公司 检验检测专用章	
签名: 卢创开	签名: 李新明	签名: 邱文才	
检验人: 卢创开	审核人: 李新明	批准人: 邱文才	
日期: 2022 年 01 月 13 日	日期: 2022 年 01 月 13 日	日期: 2022 年 01 月 13 日	



深圳立讯检测股份有限公司 | 地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基工业园 A 栋 101、201、C 栋 301
Room 101, 201, Building A and Room 301, Building C, Juji Industrial Park, Yabianxueziwei, Shajing
Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | Tel: +(86) 0755-8259 1330 |
Fax: +(86) 0755-8259 1332 | E-mail: webmaster@lcs-cert.com | http://www.lcs-cert.com

检验报告




广州中森检测技术有限公司
Guangzhou Zhongsen Testing Technology Co., Ltd

第 4 页 共 6 页

№: ZSJC2021122409

测试结果:

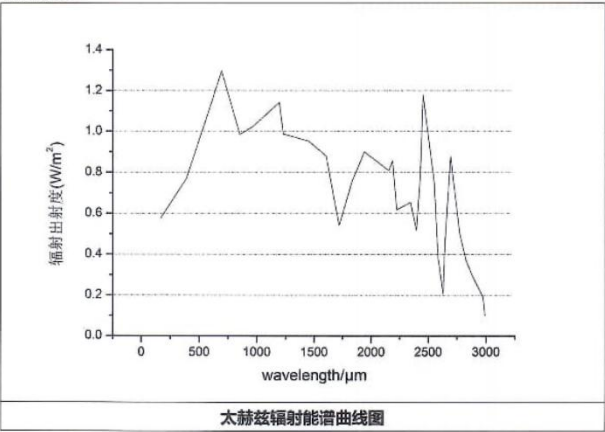

实验室检测条件: 温度 $25\pm3^{\circ}\text{C}$, 湿度 $65\pm3\%\text{RH}$
样品测试第二档, 开机5分钟左右, 出风口温度稳定后进行测试

样品名称	测试项目	检测单位	检测结果
生物能量仪	辐射波长范围(辐射能谱曲线图) (峰值) 0.75 μm -3 μm	W/m ²	0.512
	辐射波长范围(辐射能谱曲线图) (峰值) 3 μm -10 μm	W/m ²	0.523
	辐射波长范围(辐射能谱曲线图) (峰值) 10 μm -30 μm	W/m ²	0.535
	太赫兹辐射波长范围(辐射能谱曲线图) (峰值) 30 μm -1000 μm	W/m ²	1.355
	太赫兹辐射波长范围(辐射能谱曲线图) (峰值) 1000 μm -3000 μm	W/m ²	1.172




广州中森检测技术有限公司
Guangzhou Zhongsen Testing Technology Co., Ltd

第 5 页 共 6 页

光谱分布:

实验室检测条件: 温度 $25\pm3^{\circ}\text{C}$, 湿度 $65\pm3\%\text{RH}$

测试范围: 0mm~3mm/30~3000 μm

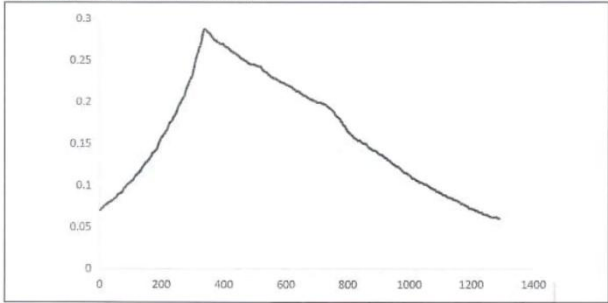

光度参数:

光通量 Φ : 10.3213 lm 辐射通量 Φ_e : 1.755W 光效: 0.03 lm/W

电参数:

电压 $U=220\text{V}$ 、电流 $I=5.2221\text{A}$ 、功率 $P=1213.35\text{W}$ 、功率因素 $\text{PF}=0.8902$

波长坐标: $x=0.1983$ $y=0.3718$ ($\text{duv}=8.15\text{e-}04$)

主波长: $\lambda_d=400\text{-}1200\mu\text{m}$ 太赫兹波长: 30~1200 μm =28.33%

测试设备:

检测设备	设备品牌	设备型号
红外辐射检测器	深圳万仪通	JPS-SX
太赫兹辐射检测器	中电科仪器	3643X

辐射水平检测

 Prife





专利号	专利名称	专利类型
2022219481639	一种符合人体工学的养生设备	实用新型
2022218905592	一种防水性能好的足疗装置	实用新型
2022223178390	一种带有负离子除臭功能的足疗设备	实用新型
2022223033813	一种支撑稳定的养生设备	实用新型
2022222432233	一种带有石墨烯加热装置的足疗设备	实用新型
2022221384266	一种绝缘性能好的微电流足疗装置	实用新型

一种符合人体工学的养生设备

一种防水性能好的足疗装置

一种带有负离子除臭功能的足疗设备

一种支撑稳定的养生设备


一种带有石墨烯加热装置的足疗设备

一种绝缘性能好的微电流足疗装置



适用人群


寒湿体质
办公室人群
产后宝妈
肥胖人群
爱美群体
中老年人群
久坐久站人群
三高人群



居家



康养中心



美容院



SPA中心



疗养院



活动中心

适用场景

居家
康养中心
美容院
SPA中心
疗养院
活动中心
办公室

THANK YOU!

谢谢！



iTera - *Bio*